


射洪县中医院手术室内镜清洗中心方案设计

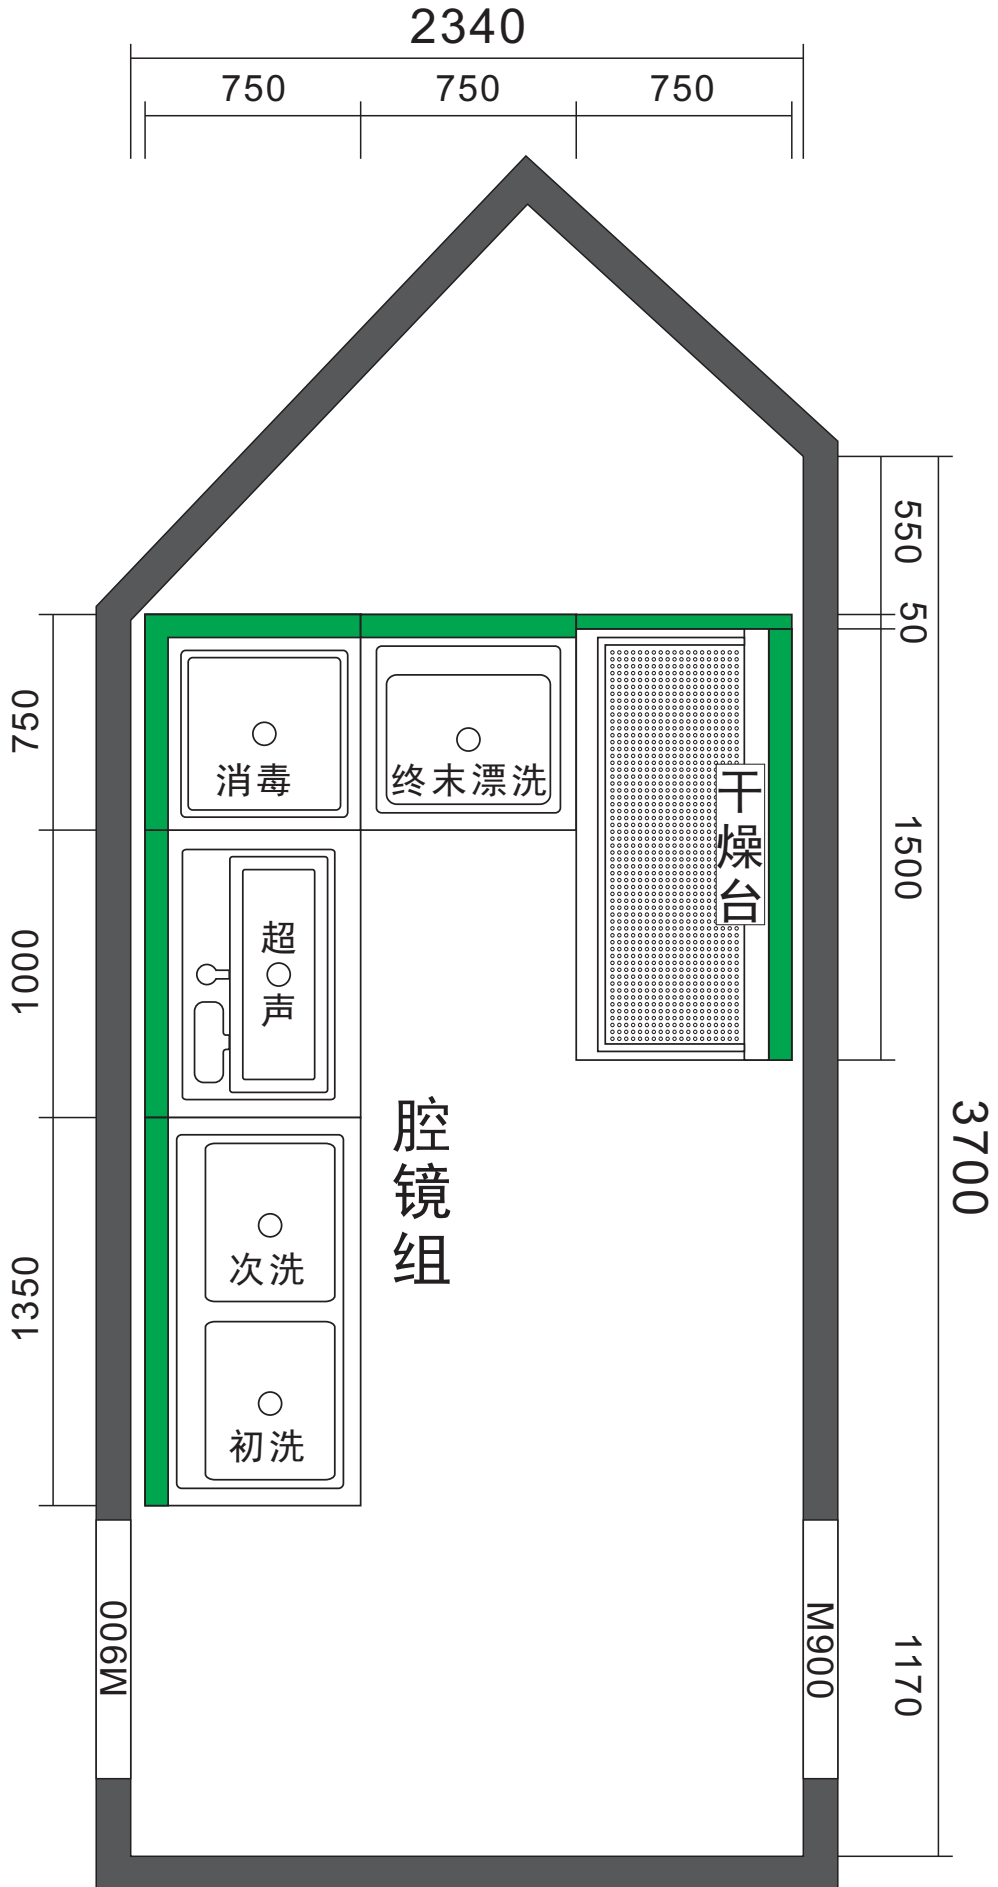

射洪县中医院手术室内镜清洗中心配置清单

序号	项目	单位	数量	备注
1	中背板	米	4.35	
2	计时器	个	2	
3	高压供水器	台	1	
4	水处理器	个	1	
5	高压供气机	台	1	
6	空气过滤器	台	1	
7	气体处理器	台	1	
8	专用水龙头	个	3	
9	气水混合枪	把	1	
10	高压水枪(八头)	把	1	
11	高压水枪(单头)	把	1	
12	高压气枪	把	4	
13	方槽盖	个	1	
14	超声波清洗机	套	1	